

Goiânia, 15 de Fevereiro de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 01/2018

1. MATERIAL

23272 Alça de polipectomia reutilizável com Manopla

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Alça de polipectomia tipo crescente em aço inox, tipo Oval, medindo 23 mm a 27 mm de diâmetro do laço, para canal de trabalho 2,8 mm, com 230 cm a 240 cm de comprimento útil. Com Manopla acoplada em acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), utilizado em retirada de pólipos e pequenos tumores do trato gastrointestinal, excisão de áreas lesadas da parede esofágica, devido presença de corpos estranhos. Embalados em material que garanta a integridade do produto, apresentação do produto, deverá obedecer a legislação vigente, autoclavável.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Permite a excisão de pólipos e captura de corpos estranhos no trato gastrointestinal, durante a realização dos exames de endoscopia. A aquisição se faz necessária devido a alta demanda de troca de sonda de gastrostomia e necessidade de polipectomia.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 unidades (foto em anexo)


Tereza
Tereza Cristina Duarte
Coordenação de Enfermagem
HDT/HAA
COREN-GO: 47.388




Sabrina Karla de Lima
Enfermeira
COREN-GO 422.943

Sabrina Karla de Lima
Supervisão CC/CME
COREN: GO – 422.943

Antônio Jorge de A. Maciel
Gerente Administrativo
HDT/HAA
Vander de Monteiro de S. Junior
Comprador
HDT/ISG-GO

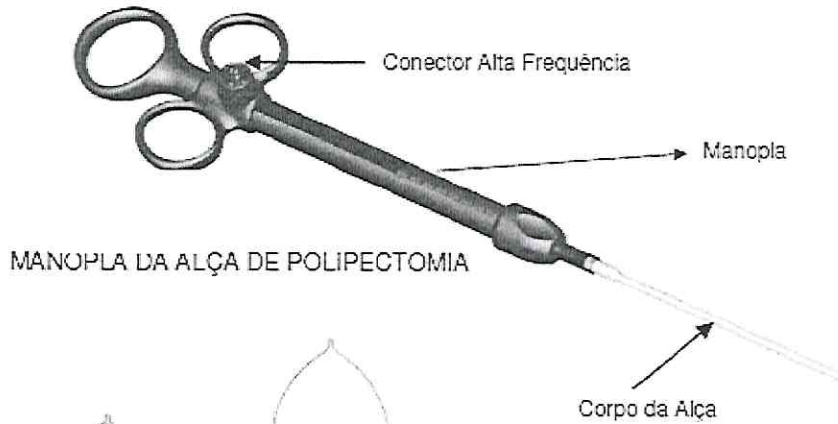

MANOPLA DA ALÇA DE POLIPECTOMIA

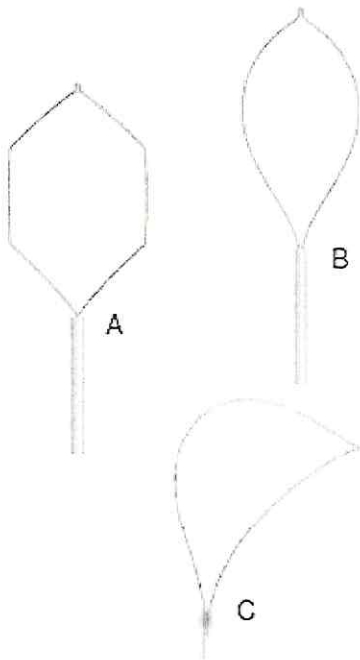

FORMATOS DA ALÇA DE POLIPECTOMIA
 A - Hexagonal
 B - Oval
 C - Assimétrica

Cristina Duarte
 Fabiana Cristina Duarte
 Coordenação de Enfermagem
 HDT/HAA
 COREN-GO: 47.383

[Handwritten mark]

Vander de Monteiro dos S. Junior
 Comprador
 HDT/ISG-GO