

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de Osmose reversa portátil

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
() Troca de equipamento obsoleto
() Expansão de serviços
() Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Alas, Emergência e UTIs

Considerando que o HDT possui uma osmose reversa fixa que somente atende a UTI.

Considerando que outras áreas, como a emergência, UTI Covid e UTI pediátrica também precisa de realizar hemodiálise e não possuem osmose.

Considerando também a necessidade de se possuir uma osmose reversa de back-up como plano de contingência, justifica-se a aquisição destas osmoses.


OBS: O SIGEM não possui osmose reversa para hemodiálise, que no caso de duas saídas, foi solicitado no mínimo 90 litros/hora. O SIGEM apenas possui osmose de 10 e 20 litros/hora.

Especificação desejada**Osmose reversa portátil de 2 saídas**

Osmose reversa portátil que permita atender até duas máquinas de hemodiálise simultaneamente.

Vazão que atinja no mínimo 90 litros / hora.

Produção do permeado de diálise a partir da água potável



Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Ciclos de lavagem automáticos

Pré-filtragem integrada, incluindo abrandador

Deve possuir revestimento acústico que permita trabalhar de forma silenciosa.

Deve possuir 4 rodízios para movimentação, de no mínimo 4".

Deve possuir condutivímetro acoplado.

Deve fornecer água para hemodiálise que atenda as exigências da RDC
11/2014 e a PORTARIA Nº 82, DE 03 DE JANEIRO DE 2000

Deve possuir registro da ANVISA vigente

Alimentação: 220 Volts / 60 Hz

Deve possuir registro na ANVISA vigente

Deve possuir garantia mínima de 1 (um) ano após a instalação.

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
VEXER	01	OSMOSE REVERSA PORTÁTIL	1	VEXER	31.000,00	62.000,00
ALLCA	01	OSMOSE REVERSA PORTÁTIL	1	Permutation	32.690,00	65.380,00
WJ COMÉRCIO	01	OSMOSE REVERSA PORTÁTIL	1	VEXTER	42.050,00	84.100,00




Ismael Moreira de Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad



SES
Secretaria de Estado
de Saúde



É POR
VOCÊ
QUE A
CENTE
FAZ

Especificação – OSMOSE REVERSA PORTÁTIL

VEXTER Item 1

Especificação do item:

OSMOSE REVERSA PORTÁTIL MODELO VOP00100VAZÃO DE 120L/HORA

Especificação – OSMOSE REVERSA PORTÁTIL

ALLCA Item 1

Especificação do item:


OSMOSE REVERSA PORTÁTIL OR-1000 PERMUTION


Especificação – OSMOSE REVERSA PORTÁTIL

WJ COMÉRCIO Item 1

Especificação do item:

OSMOSE REVERSA PORTÁTIL 2 SAÍDAS VEXTER MODELO VOP00180 VAZÃO DE 180 LITROS/HORA

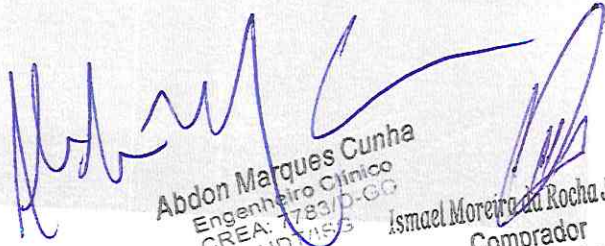
Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 1783/D-GO
HDT/153


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / 153 - GO