

**Solicitação de Investimento**

Solicitado por:	PATRÍCIA MOREIRA DE ARAUJO LISBOA
Elaborado por:	ISMAEL MOREIRA
Aprovado por:	CAMILA COSTA

<b>Objetivos</b>	Aquisição de aspirador portátil
<b>Característica do investimento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nova tecnologia <input type="checkbox"/> Troca de equipamento obsoleto <input type="checkbox"/> Expansão de serviços <input type="checkbox"/> Outro: Descreva _____
<b>Justificativa fundamentada</b>	<p>Local: Alas, Emergência, UTIs e Centro Cirúrgico</p> <p>Considerando que hoje o HDT possui 3 unidades de terapia intensiva.</p> <p>Considerando que o HDT loca os aspiradores cirúrgicos porque não possui aspiradores para as UTIs.</p> <p>Considerando a exigência da RDC 7 de se possuir aspiradores nas unidades de terapia intensiva.</p> <p>Considerando que o centro cirúrgico possui 3 salas cirúrgicas, mas apenas 2 aspiradores funcionando, sendo que os dois já estão bem antigos, justificando desta forma a aquisição destes equipamentos.</p>
<b>Especificação desejada</b>	<p><b>ITEM 1 - Aspirador cirúrgico de 1 frasco</b></p> <p>Motor a pistão e isento de óleo;</p> <p>Gabinete protegido contra penetração de água;</p> <p>Ajuste de intensidade de aspiração / vácuo;</p> <p>Proteção de saída por filtro de ar de alta capacidade;</p> <p>Fluxo de aspiração maior ou igual a 15 LPM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacuômetro com faixa de leitura de 0 a -760 mmHg / 0 a -100 Kpa;</li> </ul>

*Camila Costa*  
Garente Administrativa  
HDT/ISG

*Patricia Lisboa*  
RTE Coordenadora de Enfermagem  
HDT/ISG

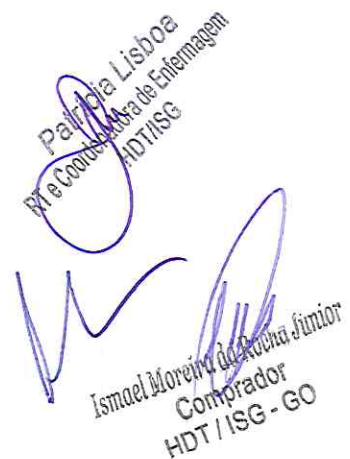

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
Comprador  
HDT / ISG - GO

Tecla para seleção de modo de operação: contínuo ou intermitente;  
Duplo sistema de proteção de entrada por filtro hidrofóbico e bóia mecânica integrada que interrompem a aspiração e impedem o transbordamento em caso de frasco cheio;  
Frasco coletor com capacidade igual ou superior a 5 litros, autoclavável e com alça na tampa para facilitar o transporte – deve acompanhar pelo menos 2 frascos;  
Deve vir montado em pedestal móvel sobre rodízios.  
Alimentação: 220 Volts, 60 Hz  
Deve possuir registro na ANVISA vigente  
Garantia mínima: 1 (um) ano

**ITEM 2 - Aspirador cirúrgico de 2 frascos**

Motor a pistão e isento de óleo;  
Gabinete protegido contra penetração de água;  
Ajuste de intensidade de aspiração / vácuo;  
Proteção de saída por filtro de ar de alta capacidade;  
Fluxo de aspiração, maior ou igual a 50 LPM;  
Vacuômetro com faixa de leitura de 0 a -760 mmHg / 0 a -100 Kpa;  
Tecla para seleção de modo de operação: contínuo ou intermitente/pedal;  
Duplo sistema de proteção de entrada por filtro hidrofóbico e bóia mecânica integrada que interrompem a aspiração e impedem o transbordamento em caso de frasco cheio;  
Sistema deve permitir acoplar pelo menos 2 frascos de forma simultânea.  
Frasco coletor com capacidade igual ou superior a 5 litros, autoclavável e com alça na tampa para facilitar o transporte – deve acompanhar pelo menos 2 frascos;  
Deve vir montado em pedestal móvel sobre rodízios.  
Alimentação: 220 Volts, 60 Hz.  
Deve possuir registro na ANVISA vigente  
Garantia mínima: 1 (um) ano

  
Camile Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

  
Patrícia Lisboa  
Diretora de Enfermagem  
HDT/ISG  
  
Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



**Cotações**

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
<b>HIPROMED</b>	01	Aspirador cirúrgico de 1 frasco	3	INALAMED	3.100,00	19.500,00
	02	Aspirador cirúrgico de 2 frascos	3	INALAMED	3.400,00	
<b>HOSPCOM</b>	01	Aspirador cirúrgico de 1 frasco	3	FANEM	8.680,00	52.080,00
	02	Aspirador cirúrgico de 2 frascos	3	FANEM	8.680,00	
<b>PRIME</b>	01	Aspirador cirúrgico de 1 frasco	3	PROTEC	9.000,00	57.600,00
	02	Aspirador cirúrgico de 2 frascos	3	PROTEC	10.200,00	

**Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO****HIPROMED** Item 1 Aspirador cirúrgico de 1 frasco

ASPIRADOR CIRÚRGICO INALAMED INL6005C-1

**Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO****HIPROMED** Item 2 Aspirador cirúrgico de 2 frascos

ASPIRADOR CIRÚRGICO INALAMED INL6003C2

Patricia Lisboa  
RT e Coordenadora de Enfermagem  
HDT/ISG

Gamila Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



## Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO

HOSPCOM Item 1 Aspirador cirúrgico de 1 frasco

ASPIRADOR CIRÚRGICO FANEM DIAPUMP COLIBRI – DPS 60 COM FRASCO DE 10 LITROS

## Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO

HOSPCOM Item 2 Aspirador cirúrgico de 2 frascos

ASPIRADOR CIRÚRGICO FANEM DIAPUMP COLIBRI – DPS 60 COM FRASCO DE 10 LITROS


Camila Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

Regina Lisboa  
RTA Coordenadora de Enfermagem  
HDT/ISG

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

**HDT**

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



É POR  
VOCE  
QUE A  
GENTE  
FAZ

**Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO**

**PRIME**

Item 1 Aspirador cirúrgico de 1 frasco

ASPIRADOR CIRÚRGICO PROTEC EVOLUTION 5000

**Especificação – ASPIRADOR CIRÚRGICO**

**PRIME**

Item 2 Aspirador cirúrgico de 2 frascos

ASPIRADOR CIRÚRGICO PROTEC EVOLUTION 10000

*Abdon Marques Cunha*  
Engenheiro Químico  
CREA: 7183/D-GO  
HDT/ISG

*Patricia Lisboa*  
RT e Coordenadora de Enfermagem  
HDT/ISG

*Cemila Costa*  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
Corporador  
HDT/ISG - GO