

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de Mesa Ortostática Motorizada

Característica do investimento

- Nova tecnologia
 Troca de equipamento obsoleto
 Expansão de serviços
 Outro: Descreva _____

Local: Fisioterapia

Justificativa fundamentada

A permanência prolongada de pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI) sob ventilação mecânica (VM) está associada ao declínio funcional, morbidades, mortalidade, cuidados de alto custo e longo tempo de internação. A sepse, distúrbios hidroeletrólíticos e a imobilidade são causas da polineuropatia do doente crítico. A administração excessiva de sedativos, bloqueadores neuromusculares, corticoesteróides e inclusive a VM são fatores que agravam a fraqueza adquirida na UTI.

Dentre as práticas recomendadas ao doente crítico, a utilização da prancha ortostática (PO) para promover os benefícios do ortostatismo assistido tem sido sistematicamente recomendada pelas diretrizes de cuidados críticos.

O uso do ortostatismo pode promover benefícios hemodinâmicos e cardiorrespiratórios, como: o aumento da ventilação, melhora da relação ventilação-perfusão e melhora da função cardiorrespiratória.


Considerando que o hospital HDT não possui este sistema, justifica-se sua aquisição.

Obs: A tabela do SIGEM é de uma mesa manual. Estamos adquirindo uma elétrica por quase o mesmo preço da tabela.

Especificação desejada**Mesa ortostática Motorizada**

Mesa construída em estrutura tubular de aço com pintura eletrostática sou material

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comptador
HDT/ISG-GO



superior montada sobre rodízios, com sistema de freios.

Tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica, encosto estofado em courvin

Sistema de inclinação elétrica de 0 a 90 graus (variação de +/- 10%) por controle remoto com ou sem fio

Capacidade de carga de no mínimo 110 quilos.

Deve acompanhar:

01 jogo de faixas para fixação do paciente

Voltagem: 220 Volts, 60 Hz

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
CARCI	01	Mesa Ortostática Motorizada	2	CARCI	6.927,50	13.855,00
LUNAX	01	Mesa Ortostática Motorizada	2	Salutem	9.890,00	19.780,00
APARECIDA MED	01	Mesa Ortostática Motorizada	2	CARCI	11.277,89	22.555,78

Especificação – MESA ORTOSTÁTICA MOTORIZADA

CARCI Item 1

Especificação do item:

Mesa Ortostática, marca Carci, Modelo 1212

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO



Especificação – MESA ORTOSTÁTICA MOTORIZADA**LUNAX**


Item 1

Especificação do item:



Mesa ortostática Motorizada – Marca Salutem S8093

Especificação – MESA ORTOSTÁTICA MOTORIZADA**APARECIDA MED** Item 1**Especificação do item:**

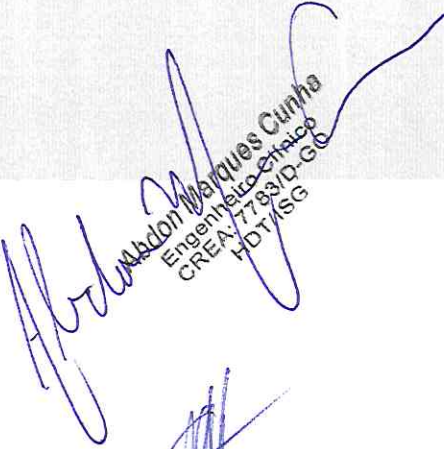Mesa Ortostática Motorizada CARCI, com sistema de inclinação elétrico



Abdon Marques Cunha
Engenheiro Eletricista
CREA 17.883/D-GO
HDT/ISG



Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO